

Set de Verificación de Calibración de Nitrito para Checker[®] HC – HI708-11

SKU: HI 708-11

RESUMEN

El Set de Verificación de Calibración de Nitrito para Checker[®] HC - HI708-11 proporciona una solución simple para validar el Checker[®] HC para Nitrito de Rango Alto - HI708 en el rango de 0 a 150 ppm (mg/L) de nitrito. Este set de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última tecnología y viene con un Certificado de Análisis. El Certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al verificar el Checker[®] HC.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 75 +/- 5 ppm de nitrito a 25 °C
- Reutilizable con larga vida útil

DESCRIPCIÓN

El set de verificación de calibración de nitrito para Checker® HC **HI708-11** proporciona una solución simple para validar el Checker® HC para nitrito de rango alto **HI708** en el rango de 0 a 150 ppm (mg/L) de nitrito. Este set de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última tecnología y viene con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al verificar el Checker® HC.

ESPECIFICACIONES

Certificado de análisis	Sí
Envase	Cubetas
Cantidad de análisis	1 set


ACCESORIOS

El **HI708-11** es un set de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar el Checker® HC para nitrito de rango alto **HI708**. El **HI708-11** incluye una cubeta sellada para cero ppm de nitrito y una cubeta con coloración equivalente a 75 +/- 5 ppm a 25 °C de nitrito.

-Reutilizable con larga vida útil.

-Se suministra con certificado de análisis:

- Código de producto
- Número de lote
- Fecha de caducidad

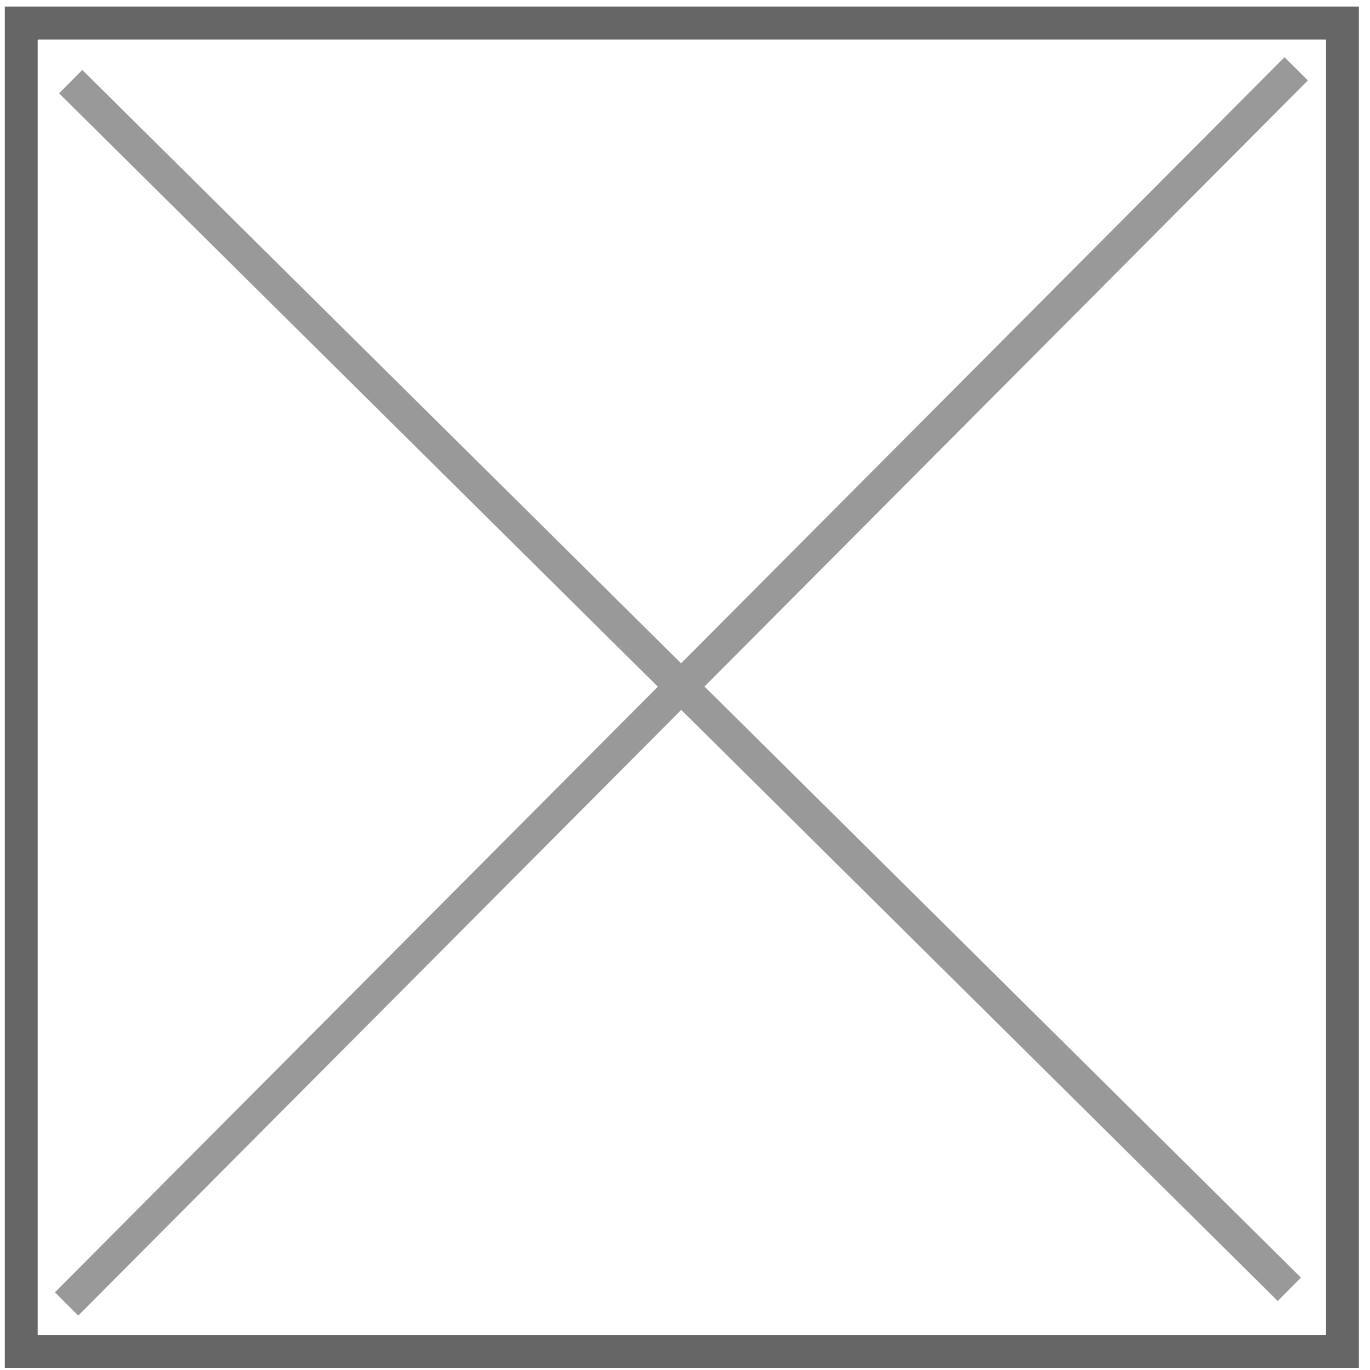

.

.

HI708, HI708-11, HI 708-11, Set de Verificación de Calibración de Nitrito para Checker® HC

www.hannachile.com Descargado desde: <https://hannachile.com/producto/skuhi707-11-product-nameset-de-verificacion-de-calibracion-para-checker-hc-de-nitrito-rango-bajo-hi707-11-stock-status-messagedelivery-up-to-30-days-quote-requiredno-certificado-de-analisi/>