HI981520 Monitor Marino de pH, Salinidad Marina, y Temperatura
Guía de Referencia Rápida

Estimado Cliente,

Gracias por elegir Hanna Instruments.

El Monitor Marino HI981520 es la solución ideal para los acuaristas que buscan monitorear continuamente los niveles de salinidad en sus acuarios.

Aplicación: monitoreo de la salinidad en acuarios de agua salada, agua de mar o acuicultura

Contenido del Paquete

- HI981520 Monitor con sonda de CE y temperatura adjunta
- HI1286 Electrodo de pH reemplazable
- Solución tampón de pH 7.01, 20 mL (2 sobres)
- Solución tampón pH 10.01, 20 mL (2 sobres)
- Solución de calibración de salinidad de 35.00 ppt, 20 mL (2 sobres)
- Solución de limpieza de electrodos, 20 ml (2 sobres)
- Ventosa (2 piezas)
- Tira autoadhesiva (2 piezas)
- Adaptador de corriente de 12 VCC
- Certificado de calidad del electrodo de pH
- Guía de referencia rápida con certificado de calidad del instrumento

Principales Características

- Dos modos de funcionamiento de Alarma (valor Alto/Bajo) para cada parámetro admitido
- Alarma Alta/Baja generada cuando el valor medido excede o cae por debajo del parámetro configurado Valor Alto/Bajo
- Señal acústica generada cada vez que se dispara una alarma
- La sonda de CE contiene un sensor de temperatura integral que simplifica la instalación
- Todas las lecturas están compensadas por variaciones de temperatura

Breve Resumen Operativo

- Utilice las tiras suministradas para montar el Monitor (opcional).
- Deslice la funda del conector hacia abajo y conecte el electrodo de pH a la entrada BNC. Deslice la funda hacia arriba y asegúrese de que el conector esté cubierto.
- Conecte el adaptador de corriente al instrumento y enchúfelo a la red eléctrica.
- Presione SETUP para ingresar a Configuración.
- Presione ▶ para entrar en el modo de edición.
- Presione ▲/▼ para navegar por el menú y configurar los límites operativos del proceso.
- Retire la tapa protectora del electrodo de pH y coloque tanto el electrodo de pH como la sonda de CE en la misma solución de calibración de pH.
- Presione CAL para calibración de pH. La solución tampón se reconoce automáticamente.
- Coloque la sonda de CE en la solución de calibración y presione CAL para seguir con la calibración de conductividad. La solución de conductividad se reconoce automáticamente.
- Fije las ventosas suministradas para asegurar las sondas en su posición.
- Al medir, asegúrese de que tanto el electrodo de pH como la sonda de CE estén sumergidos en la muestra. Para obtener los mejores resultados, consulte el diagrama a continuación para ver la ubicación adecuada.

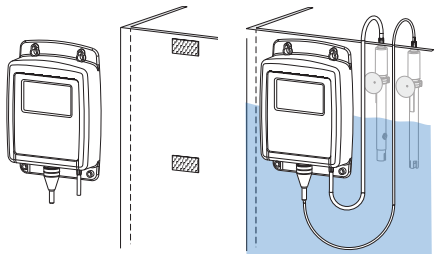

Hanna® se compromete a desarrollar e implementar soluciones digitales con un impacto positivo en el medio ambiente y el clima.

Escanee el código QR o siga el enlace para descargar el manual del usuario.
https://manuales.hannachile.com/HI981520

Todos los instrumentos de Hanna cumplen con las Directivas Europeas CE y los estándares del Reino Unido, y nuestras instalaciones de producción cuentan con la certificación ISO 9001. HI981520 está garantizado por un período de dos años y la sonda de pH por seis meses contra defectos de mano de obra y materiales cuando se usa para el propósito previsto y se mantiene de acuerdo con las instrucciones.
Para obtener información técnica, envíenos un correo electrónico a ventas@hannachile.com. Visite www.hannachile.com para obtener más información sobre Hanna Instruments y nuestros productos.

Consérvelo para uso futuro.

QR981520 11/22

HANNA®
instruments

CERTIFIED